

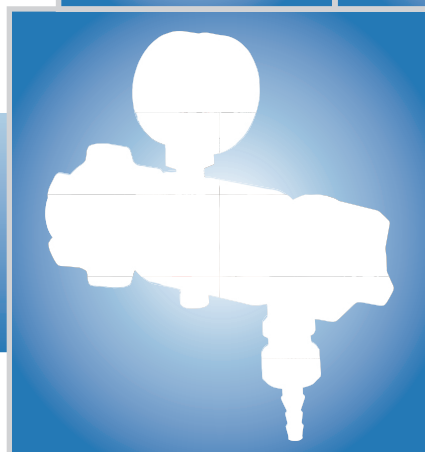
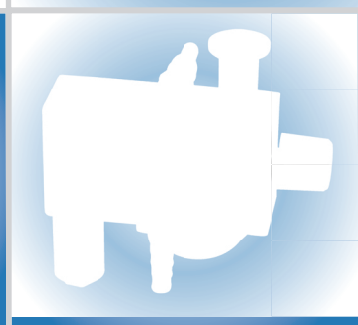


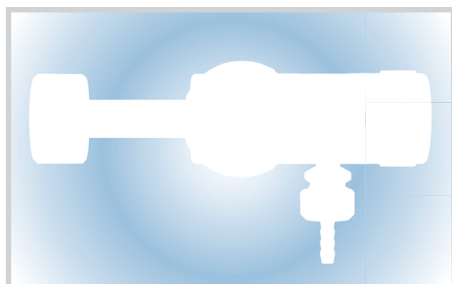

Service och reparationer av medicinteknisk utrustning

EDITION 2/2010

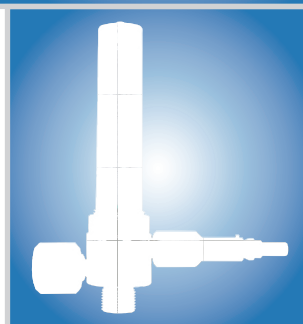

Ha full koll på er

- Ekonomi
- Funktion
- Prestanda
- Säkerhet

Medicinsk gasapplikation är ett område som kräver specialistkompetens. Kraven på säkerhet, noggrannhet och hygien är mycket höga, liksom förståelse av in- och utandningsproblematik och patientvård. Överensstämmelsen med kvalitetssystemskrav med hänsyn till det medicinska direktivet MDD 93/42/EEG i Europa och QSR – Quality System Regulations, mer känt som GMP är inte enbart ett krav utan också ett sätt att ge kunden en högkvalitativ och säker produkt när det gäller medicinteknisk utrustning så som vakuumregulatorer, sugejektorer, flödesmätare, flödesväljare, befuktare, slangar och gasuttag.

Vi erbjuder auktoriserad service, kontroll, reparationer och audits av produkter i vårt sortiment.

GCE Norden har en reparations- och serviceverkstad där service och reparationer utförs på medicintekniska produkter. Regler och förhållanden är hårt styrda för tillverkning av medicinteknisk utrustning, och gäller även under produktens livstid.

Vi har

- Auktorisation från tillverkare (ägare av CE-märke).
- Utbildad servicepersonal för medicintekniska produkter.
- MDD, Full Quality Assurance System Approval
- Certificate 41310777 (annex II of the directive 93/42 EEC on medical devices)
- Kvalitetsgodkända enligt: ISO 9001, ISO 13485

Kontakta GCE Nordens serviceavdelning för vidare information om vad som gäller för dina produkter.



Servicetekniker
Olle Lindblad

Telefon: 040-388 307
Mobil: 0706 388356
Email: olle.lindblad@gcegroup.com



Servicetekniker
Åke Andersson

Telefon: 040-388 308
Mobil: 0708 779377
Email: ake.andersson@gcegroup.com



Gas Control Equipment

GCE Norden AB, Källvattengatan 9, Box 21044, SE-212 23 Malmö
Telephone: +46 (0) 40 38 83 00, Fax: +46 (0) 40 38 83 50
<http://www.gcegroup.com>